12-31-10

Sample - Prepa P-10-1195
Fuel Oil # 6 TK 978
D-4294 Calibración Curve # 3 Amspec

QC-IS GAS 0.50 wt %
1/3 0.49377 wt%
2/3 0.49603 wt%
3/3 0.49602 wt%
Ave 0.49528 wt%

P-10-1195 Comp
1/3 0.49559 wt%
2/3 0.49669 wt%
3/3 0.49582 wt%
Ave. 0.49603 wt%

P-10-1195 Upper
1/3 0.49328 wt%
2/3 0.49763 wt%
3/3 0.49304 wt%
Ave 0.49315 wt%

P-10-1195 Middle
1/3 0.49793 wt%
2/3 0.49712 wt%
3/3 0.49811 wt%
Ave 0.49772 wt%

P-10-1195 Lower
1/3 0.49594 wt%
2/3 0.49604 wt%
3/3 0.49542 wt%
Ave 0.49580 wt%

RR IDF 60609 Run Daily
1/3 1.11760 wt%
2/3 1.11710 wt%
3/3 1.11693 wt%
Ave 1.11721 wt%

Se trabajo muestra P-10-1195 en curva nueva "Cal # 3 de Amspec" por instrucción del Lic Martinez. Se trabajaran todas con esta curva de calibración a partir de hoy 12-31-10. Presente Luis Morales, Nelson Rivera.

Analyzed By/Date LMF 12-31-10

Reviewed By/Date

COPIA NO CONTROLADA
Para Referencia Solamente

Durante el día de hoy 1/25/2011, Hora 1832 recibí un mensaje del Sr Waldemar Martinez dando instrucciones para que se le entregará copia de la curva #3 al comité auditor de la Autoridad Energía Eléctrica, estas instrucciones fueron autorizadas por el Sr Carlos Negrón, según me informó el Sr Waldemar Martinez.

Inf. Entregado al comité Auditor Repu. Comb.
25-Enero-2011
7:00pm

**CALIBRATION-MAN2
DATE: 10-12-16 12:41
CAL# : 3

QUADRATIC
% =A*K^2+B*K+C

A= 0.09581
B= 2.65976
C= -0.22400

RANGE:
0.10000 - 3.00000 %
STD DEV 0.03476 %

STD#	%	K
01	0.10000	0.12230
	(0.00394)	
02	0.25000	0.17390
	(-0.00683)	
03	0.50000	0.26989
	(0.00352)	
04	0.70000	0.34455
	(0.00724)	
05	1.00000	0.43971
	(-0.03156)	
06	2.00000	0.83382
	(0.06814)	
07	3.00000	1.14142
	(-0.05186)	

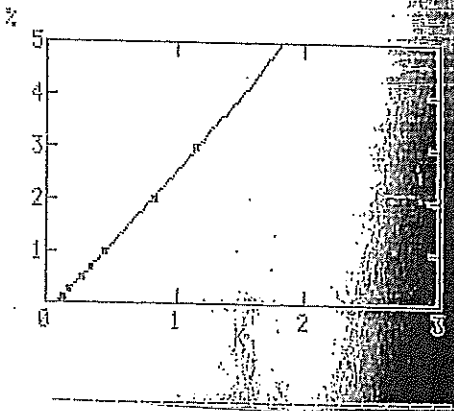

**CALIBRATION-MAN2
DATE: 10-12-16 12:41
CAL# : 3

QUADRATIC
% =A*K^2+B*K+C

A= 0.09581
B= 2.65976
C= -0.22400

RANGE:
0.10000 - 3.00000 %
STD DEV 0.03476 %
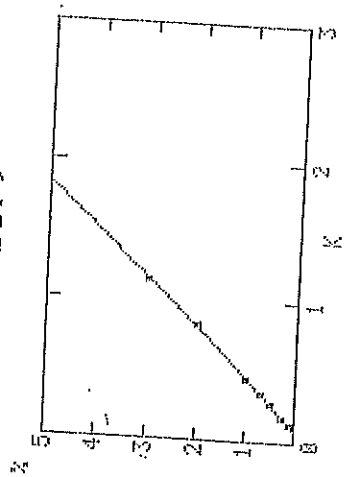
STD#	%	K
01	0.10000	0.12230
	(0.00394)	
02	0.25000	0.17390
	(-0.00683)	
03	0.50000	0.26989
	(0.00352)	
04	0.70000	0.34455
	(0.00724)	
05	1.00000	0.43971
	(-0.03156)	
06	2.00000	0.83382
	(0.06814)	
07	3.00000	1.14142
	(-0.05186)